CLEANE

PERSONAL MEDICAL DEVICE

THERMAL ACNE CARE

定点温热，治疗痤疮
2分30秒的日常护理

痤疮治疗医疗器械 CLEANE



韩国MFDS品目许可 第08-766号


FDA 510(k)

MEDICON

01 · TECHNOLOGY

直达痤疮部位的**温热技术**


温热头接触皮肤的瞬间，**恒定温度的热量**便传递至痤疮部位。

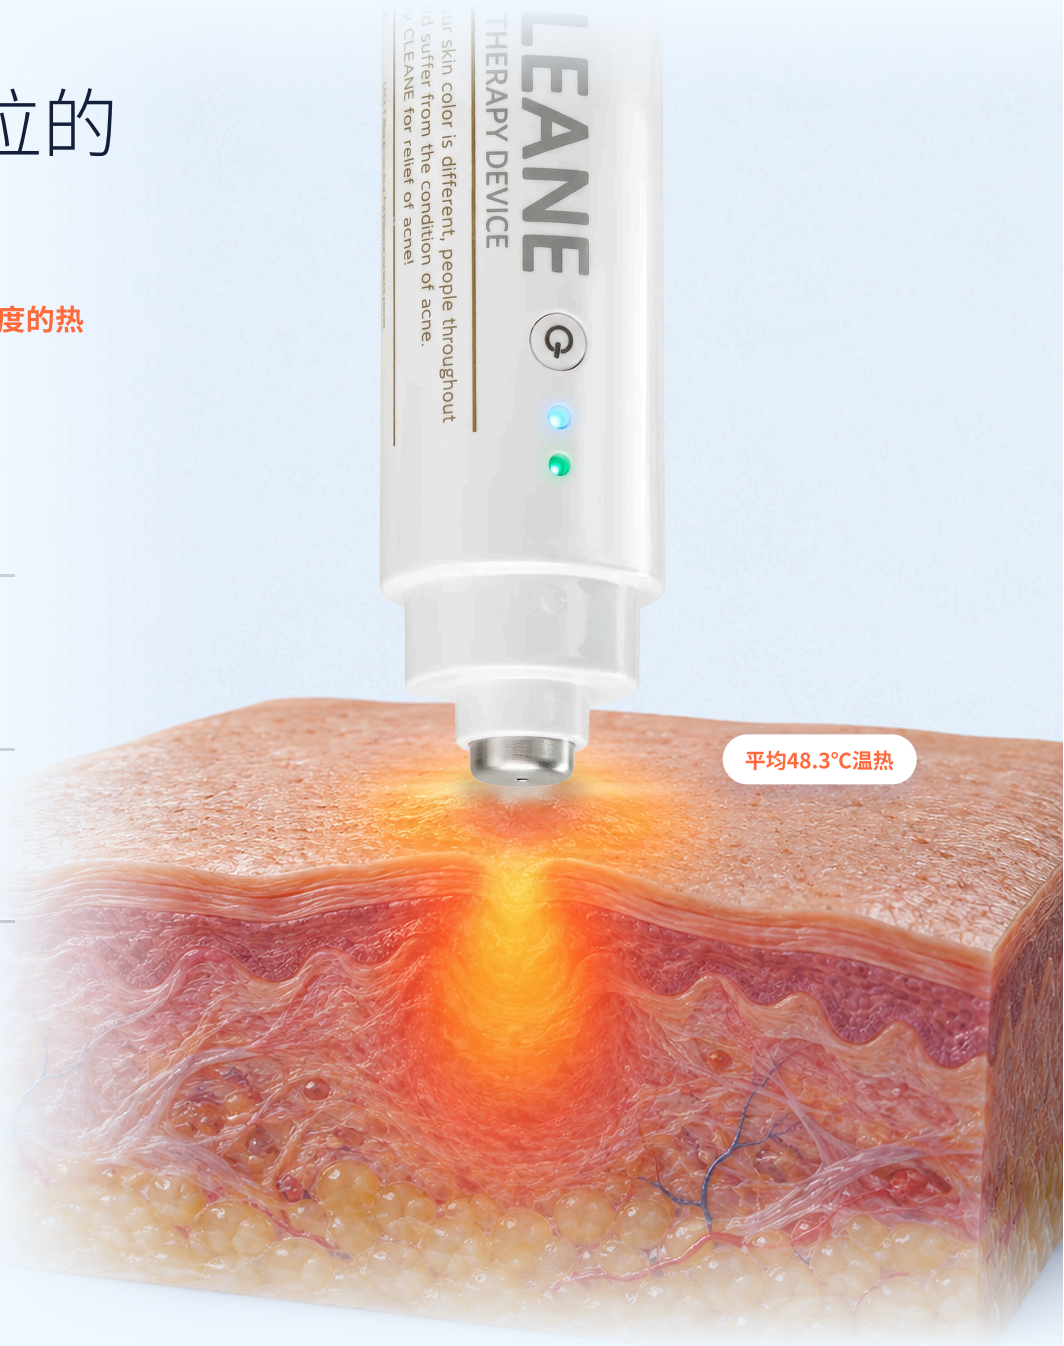

48.3 ℃
温热头平均输出温度（47.2~49.4℃）

150 秒
达到设定温度所需时间（以内）

2:30
单次使用时间 · 自动停止

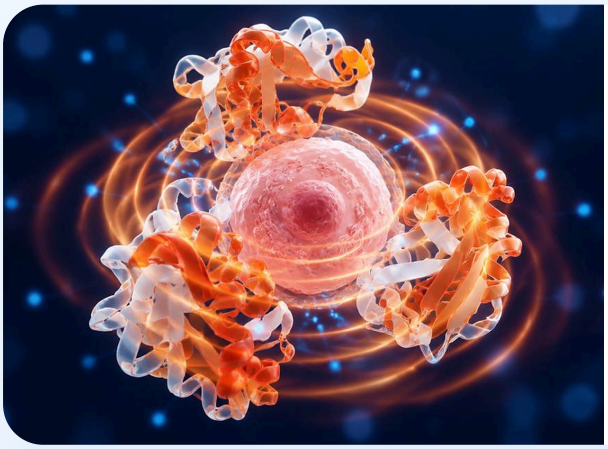

THERMAL SHOCK

热 → 热休克蛋白（HSP）合成

传递至皮肤的热量可增加HSP60、HSP70的合成，有助于针对痤疮杆菌的免疫作用。

02 · EVIDENCE

论文与试验 **给出的结果**

SCI论文 · 治疗有效率


84.6%

13人中有11人，
仅使用1次即获得积极结果

通过使用前后及6、24、48小时后的交叉偏振影像与红斑指数进行评估
· 由皮肤科专科医生判定

人体应用试验 · 72小时的变化

Dermapro公司 · 皮肤放大拍摄（×50）

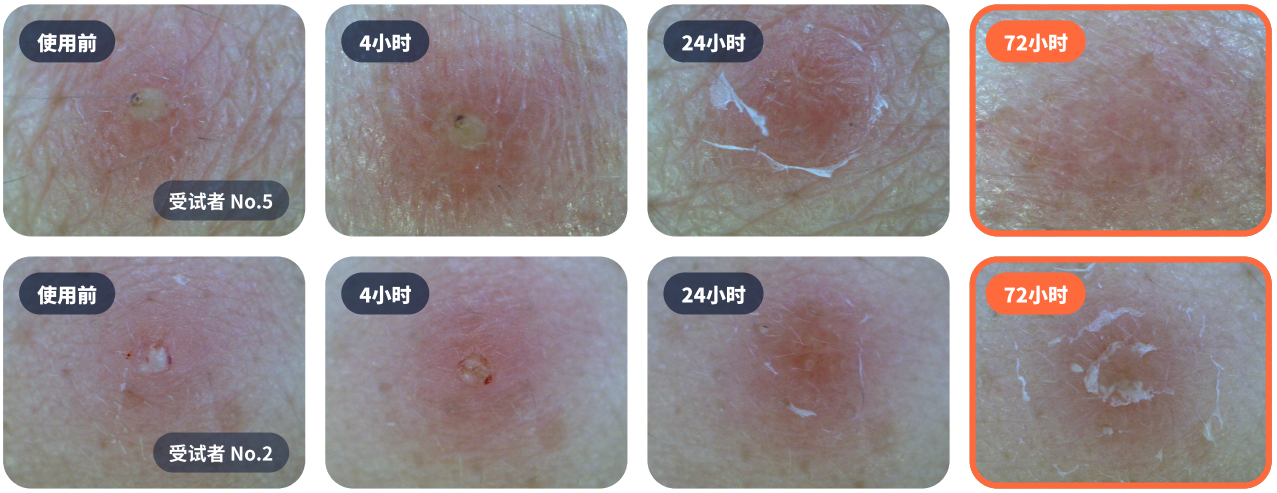

4小时后短暂发红，72小时后红斑与丘疹逐渐消退。全体受试者均回答“痤疮改善、体积缩小”。

许可 · 认证

韩国MFDS
品目许可
第08-766号

FDA
美国
510(k)

GMP
符合生产及
质量管理规范

ISO 13485
医疗器械
质量管理体系

※ 效果可能因个人皮肤状况而异。

03 · PRODUCT

小巧机身中的 **温热**



Heat

接触皮肤的温热头

金属头传递恒定温度的热量。

Auto

温度与时间，自动掌控

保持设定温度，时间一到自动停止。


Portable

30g，口红般大小

盖上保护盖放入化妆包。USB充电。

治疗的关键在于“温度”

温热头输出温度

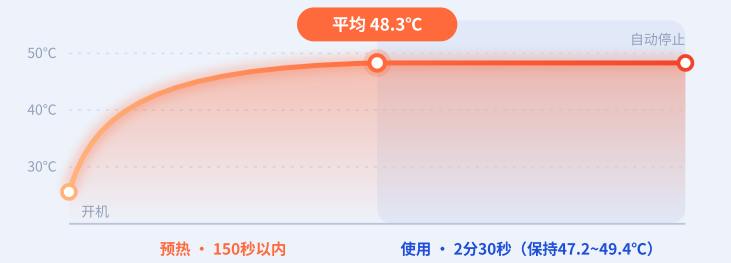

IN THE BOX

主机	1个
保护盖	1个
充电线	USB
使用说明书	1份

04 · HOW TO USE

一键操作，**轻松护理痤疮**

只需跟随指示灯颜色和提示音即可。



01

开机

短按按键，温热头开始加热。

02

准备就绪

提示音响起，指示灯闪烁。

03

使用2分30秒

再按一次按键，将温热头贴于痤疮部位。每3秒提示一次。

04

自动停止

60秒内再次按键，可继续用于其他部位。关机请长按2秒。

每天最多3次
每次使用后间隔4小时以上

同一部位最多3次
请勿超过此次数

首次使用前充电1小时
充电时无法使用

用后擦拭保存
用酒精棉擦拭后盖上保护盖

BEFORE USE

以下情况 **请勿使用**

本品为医疗器械，请务必阅读使用说明书中的注意事项。

- 黑头、白头，重度结节性・囊肿性痤疮
- 眼周、唇周等敏感部位，以及不耐热的皮肤
- 其他皮肤病、感染的皮肤、疖肿、伤口、蚊虫叮咬处
- 儿童单独使用（需监护人看管）

※ 如正在使用会导致皮肤脱皮或对热敏感的药物，请咨询医生后使用。如出现疼痛或异常反应，请立即停止使用并咨询专业人士。

CLEANE

ACNE THERAPY DEVICE



SPECIFICATION

产品名称 · 型号

医用温热器（A16150）· CLEANE

使用目的

用于痤疮治疗的个人用医疗器械（温热治疗仪）

品目许可编号（韩国MFDS）

第08-766号

输出温度

47.2 ~ 49.4 ℃ · 升温150秒以内

使用时间

2分30秒（自动停止）

电池

DC 3.7V · 250mAh · 功耗 3VA

充电

USB充电（附充电线）

重量 · 制造商

30 g · MEDICON Co., Ltd.，韩国

本品为医疗器械。使用前请务必确认注意事项及使用方法。

MEDICON

MEDICON Co., Ltd. T. +82-2-3672-1291~4 | medicon@medicon.co.kr

首尔办事处 4F Sinyoung Bldg., 26 Saimdang-ro, Seocho-gu, Seoul, Korea

总部 · 工厂 Rm. 506, Medical Device Comprehensive Support Center,
200 Gieopdosi-ro, Jijeong-myeon, Wonju-si, Gangwon State, Korea

medicon.co.kr